

INFORME DE INDICADOR DEL AREA DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ENERO 2025

Departamento / Área: Laboratorio clínico	Vigente a partir de: Enero 2025	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 1 de 5

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	Atención Centrada en el Paciente (SAD.1)
2. Problema detectado	Se detecta la incidencia de entrega de resultados fuera de tiempo sin respetar las necesidades de los pacientes
3. Nombre del indicador	Porcentaje de estudios entregados fuera de tiempo
4. Algoritmo	$= \frac{\# \text{ de total de resultados entregados fuera de tiempo}}{\# \text{ total de resultados entregados}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	El indicador describe la cantidad de estudios entregados en tiempo y forma respetando las necesidades de atender la salud de los pacientes oportunamente.
6. Objetivo	¿Qué se pretende con este indicador? Que los resultados de los laboratorios solicitados por los médicos sean entregados oportunamente para que la atención del paciente sea de calidad y se tomen las decisiones pertinentes en el momento adecuado. ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? Tener menos del 5% de estudios entregados fuera de tiempo en un periodo mensual. Sobre este resultado se va a realizar el análisis de resultados. ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? Se pretende llegar a tener el 100 % de los estudios entregados en tiempo y forma. ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso?
7. Alcance	¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Pacientes y personal de CEMA ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Admisión, Call Center, enfermería, Laboratorio clínico en general. ¿Los pacientes y familiares están involucrados? Si
8. Proceso (método) de obtención	Indicar los pasos a seguir para. a) Medir el indicador: 1. El laboratorista deberá acordar la fecha y hora de entrega de resultados con base en las necesidades del paciente pero sin sobrepasar la capacidad operativa del laboratorio.

Elaboró	Valido
TLQ. Susana Elizabeth Origel Addauto LABORATORISTA	Dr. Juan Francisco Martinez Campos DIRECTOR MEDICO
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

Página 3 de 5

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

INFORME DE INDICADOR DEL AREA DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ENERO 2025

Departamento / Área: Laboratorio clínico	Vigente a partir de: Enero 2025	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 4 de 5

3. Algoritmo


$$= \frac{\# \text{ de total de resultados entregados fuera de tiempo}}{\# \text{ total de resultados entregados}} \times 100$$

4. Resultados del algoritmo

$$\text{ENERO 2025} = \frac{0 \times 100}{232} = 0. \%$$

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO ENTREGADOS FUERA DE TIEMPO EN EL MES DE ENERO 2025

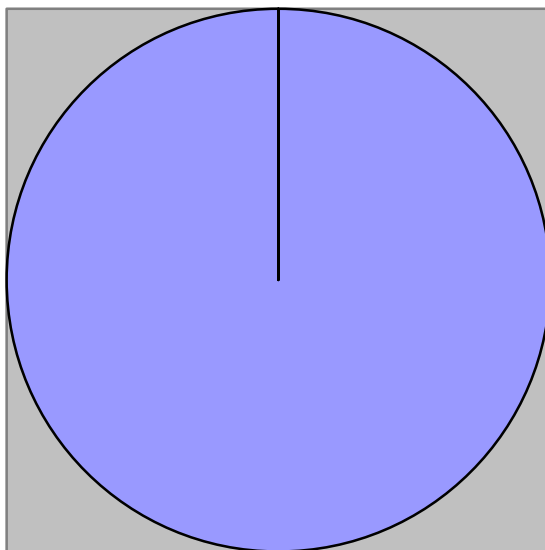


- RESULTADOS ENTREGADOS A TIEMPO 100%
- RESULTADOS ENTREGADOS FUERA DE TIEMPO 0%

Elaboró TLQ. Susana Elizabeth Origel Addauto LABORATORISTA	Valido Dr. Juan Francisco Martinez Campos DIRECTOR MEDICO
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME DE INDICADOR DEL AREA DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ENERO 2025

Departamento / Área: Laboratorio clínico	Vigente a partir de: Enero 2025	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 5 de 5

6. Conclusiones

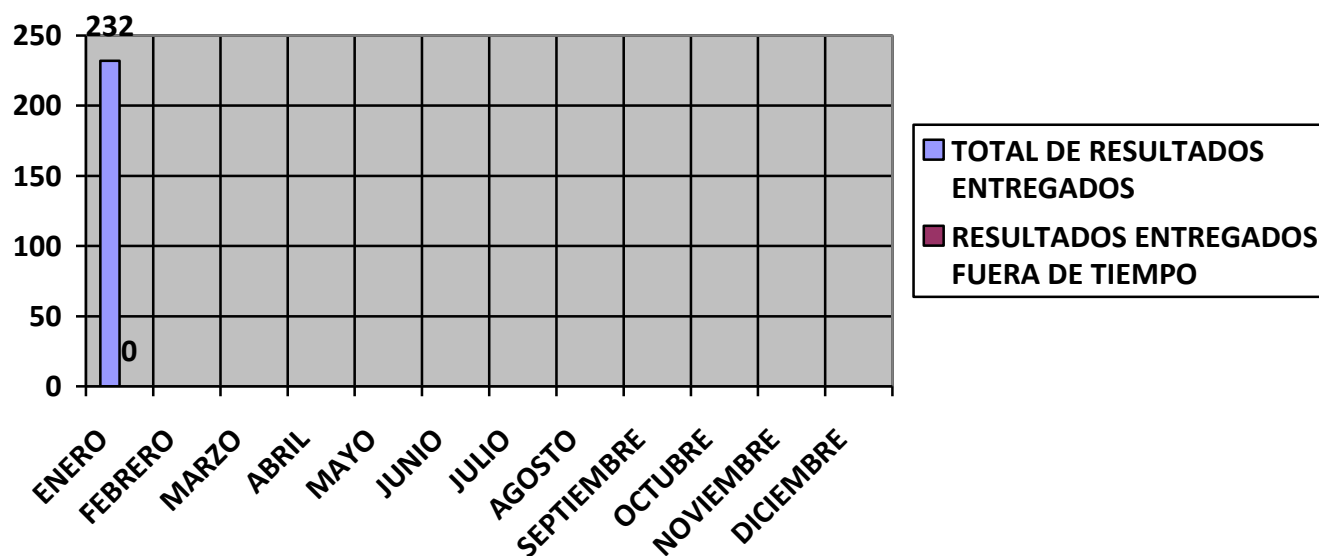

Durante este mes se logro cumplir con la meta fijada de acuerdo al indicador obteniendo un 0. % de resultados entregados fuera de tiempo.

Elaboró TLQ. Susana Elizabeth Origel Addauto LABORATORISTA	Valido Dr. Juan Francisco Martinez Campos DIRECTOR MEDICO
--	---