

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Agosto 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 1 de 7

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE PROCESO/RESULTADO	
1. Estándar	¿A qué estándar pertenece el indicador? SAD.2.9 Se han implementado un Programa de Control de Calidad interno y externo
2. Problema detectado	Desechos innecesarios de película radiográfica por diversos factores (falla de impresora, envío de estudio mal fotografiado, etc.)
3. Nombre del indicador	Porcentaje de placas de desecho en el área de imagenología
4. Algoritmo	Indicar la fórmula matemática que se empleara para medir el indicador, ejemplo: = $\frac{\text{\#de placas de desechos}}{\text{\#total de placas utilizadas al mes}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Existe una cantidad de placas de desecho en el área de imagenología por diferentes factores.
6. Objetivo	¿Qué se pretende con este indicador? No malgastar insumos de película radiográfica en el área de imagenología ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? No rebasar el límite mensual permitido de película radiográfica
7. Alcance	Técnico radiólogo de cada turno del área de imagenología. Área Biomédica
8. Proceso (método) de obtención	Indicar los pasos a seguir para. a) Toma de estudios adecuadamente (rx, rm) b) Recolectar los datos mediante una bitácora de registro de desecho de placa c) Si existe falla de impresora, quien este en el turno debe de notificar al área biomédica para solucionar el problema.
9. Frecuencia de revisión	mensual
10. Responsable	TR. Josue Ramirez. TR: RICARDO CHAVEZ TR. Raymundo Castro TR. Alondra Lazcano TR. Julian Torres

Elaboró Alondra Lazcano Tellez Técnica Radióloga	Validó Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Área de Imagenología
--	---

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Agosto 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 2 de 7

TR. Edson Ricardo Callado Verificación: Coordinadores del tema

2. Recolección de datos

Se debe indicar y/o demostrar de donde se obtiene la información del indicador

CEMA FIFA
BITACORA DE CONTROL DE DESECHOS DE PELICULA RADIOGRAFICA
MES: Agosto 2020

FECHA	NOMBRE DEL PACIENTE	ESTUDIO REALIZADO	TURNO	NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO RADIOLOGO	MOTIVO DEL DESECHO
15/08/20	Sanchez Avila Abel	Rx Odontoides	TM	Alondra Lazcano Tellez	atraso en impresión
15/08/20	García Hdz Maria	PELVIS	TM	RCE	atraso en impresión
21/08/20	Zamora Aparicio Mauricio	Teledensitax	TM	Alondra Lazcano Tellez	impresión equivocada
20/08/20	Woods del Arenal Perez	Rm Pectoral	TM	Alondra Lazcano Tellez	impresión equivocada
21/08/20	Calibración de impresora	Calibración	TM	Alondra Lazcano Tellez	calibración de equipo
25/08/20	Camila Carrasco Zúñiga	Rx Codo	T.U	Alondra Lazcano Tellez	impresión equivocada
26/08/20	Luis Gardo Saez Gato	Pa Taca	TV	TGJ	Error de envío

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V. CLAVE: CEMA-RG-III-CPR-04 / V.1.0

Elaboró Alondra Lazcano Tellez Tecnica Radióloga	Validó Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Area de Imagenología
--	---

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Agosto 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 3 de 7

3. Algoritmo

Se debe colocar la fórmula matemática declarada para el indicador.

Numero de placas de desecho $X \frac{\quad}{\quad} 100 =$
Numero de placas utilizadas en el mes


4. Resultados del algoritmo

Colocar el algoritmo con los resultados de los meses que se van a presentar

$\frac{7 \text{ placas de desecho}}{907 \text{ placas utilizadas en Agosto 2020}} X 100 = 0.7\%$

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

Esquematzación de los resultados del algoritmo.

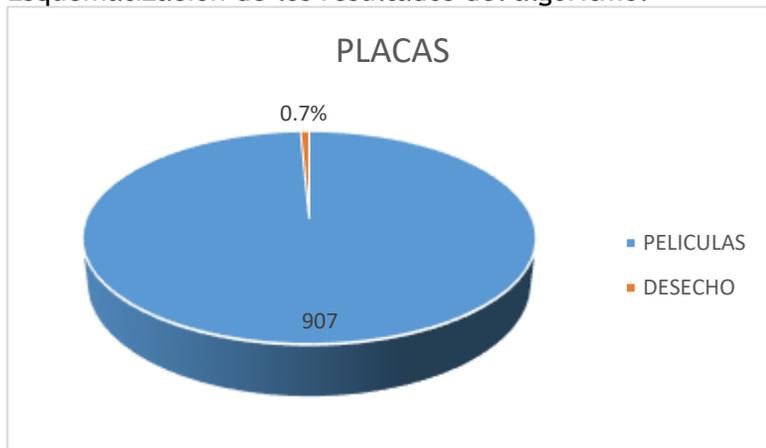

Elaboró

Alondra Lazcano Tellez
Tecnica Radióloga




Validó

Aldo Isaac Vázquez Godínez
Jefe del Area de Imagenología

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Agosto 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 4 de 7

6. Representación gráfica comparativa

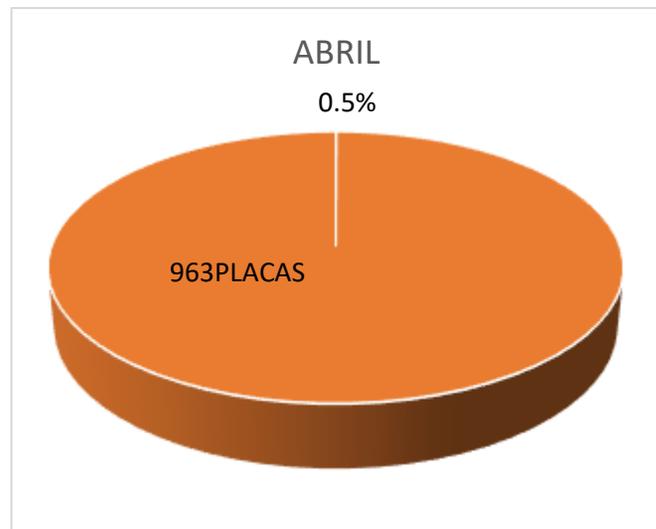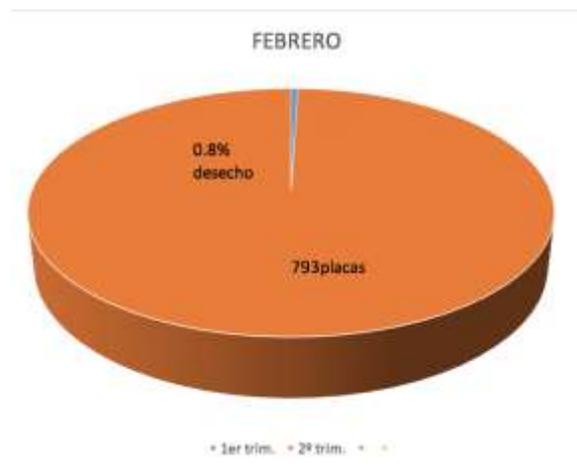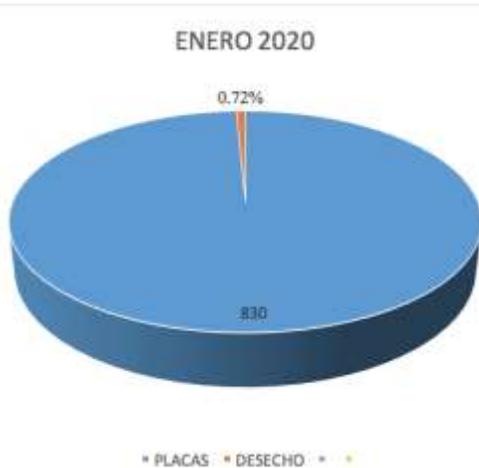

Elaboró



Alondra Lazcano Tellez
Técnica Radióloga

Validó

Aldo Isaac Vázquez Godínez
Jefe del Área de Imagenología

INFORME DE INDICADOR


Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Agosto 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 5 de 7

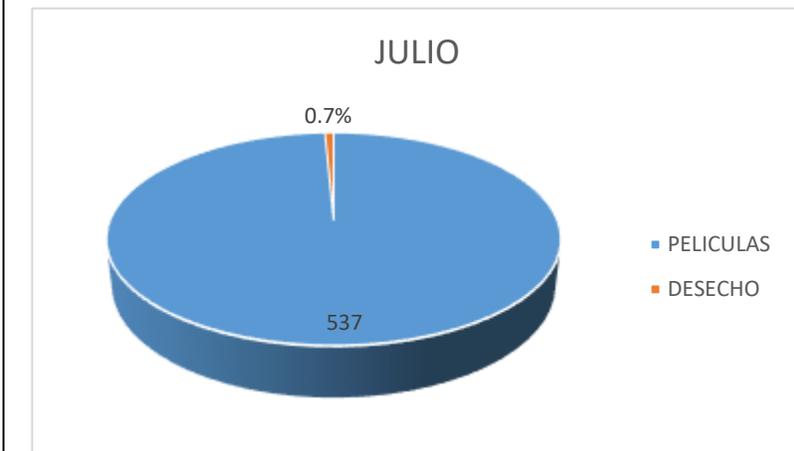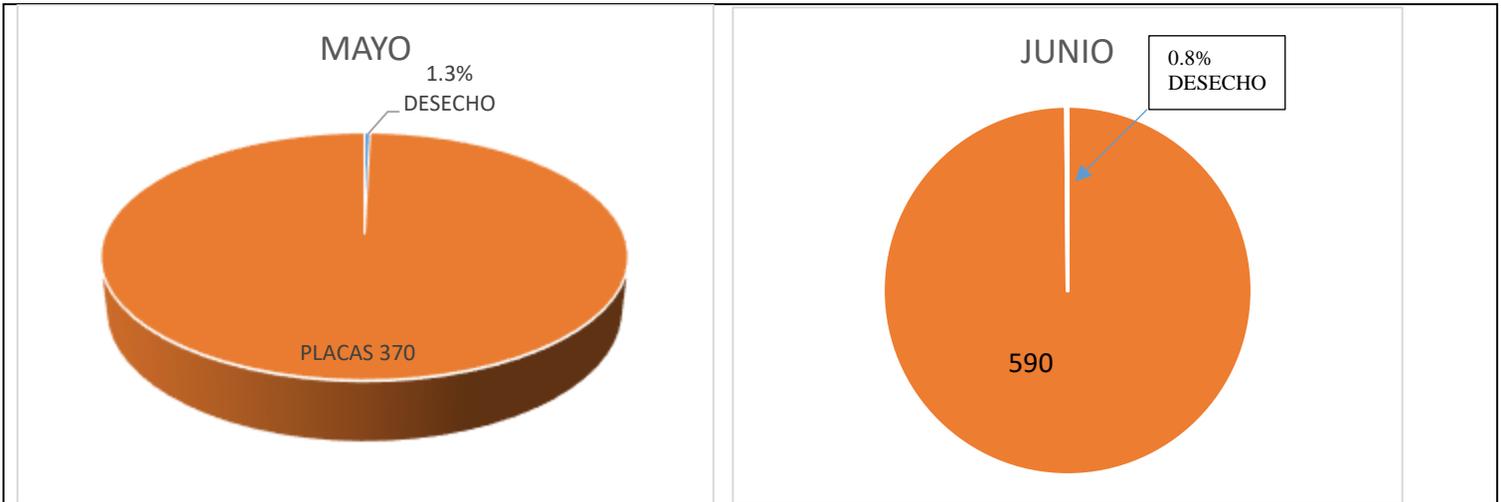

Elaboró	Validó
Alondra Lazcano Tellez Tecnica Radióloga	Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Area de Imagenología

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Agosto 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 6 de 7

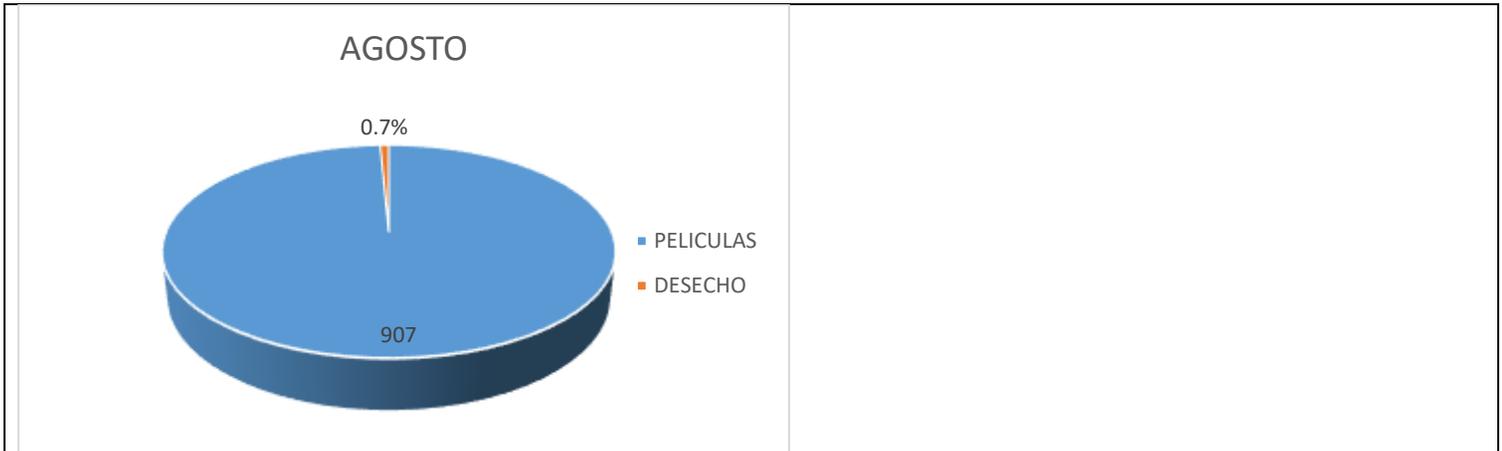

7. Conclusiones

- 1.- El área de Imagenología presenta desecho de película radiográfica pero no excede del 10 % permitido.
- 2.- principales motivos de desecho durante el mes de Agosto 2020 fue por impresión equivocada.

Elaboró	Validó
Alondra Lazcano Tellez Técnica Radióloga	Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Area de Imagenología



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Agosto 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 7 de 7

Elaboró

Alondra Lazcano Tellez

Técnica Radióloga

Validó

Aldo Isaac Vázquez Godínez
Jefe del Área de Imagenología