



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Noviembre 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 1 de 9

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE PROCESO/RESULTADO	
1. Estándar	¿A qué estándar pertenece el indicador? SAD.2.9 Se han implementado un Programa de Control de Calidad interno y externo
2. Problema detectado	Desechos innecesarios de película radiográfica por diversos factores (falla de impresora, envío de estudio mal fotografiado, etc.)
3. Nombre del indicador	Porcentaje de placas de desecho en el área de imagenología
4. Algoritmo	Indicar la fórmula matemática que se empleara para medir el indicador, ejemplo: = $\frac{\# \text{de placas de desechos}}{\# \text{total de placas utilizadas al mes}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Existe una cantidad de placas de desecho en el área de imagenología por diferentes factores.
6. Objetivo	¿Qué se pretende con este indicador? No malgastar insumos de película radiográfica en el área de imagenología ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? No rebasar el límite mensual permitido de película radiográfica
7. Alcance	Técnico radiólogo de cada turno del área de imagenología. Área Biomédica
8. Proceso (método) de obtención	Indicar los pasos a seguir para. a) Toma de estudios adecuadamente (rx, rm) b) Recolectar los datos mediante una bitácora de registro de desecho de placa c) Si existe falla de impresora, quien este en el turno debe de notificar al área biomédica para solucionar el problema.
9. Frecuencia de revisión	mensual
10. Responsable	TR. Josue Ramirez. TR: RICARDO CHAVEZ TR. Raymundo Castro TR. Alondra Lazcano TR. Julian Torres

Elaboró	Validó
Alondra Lazcano Tellez Técnica Radióloga	Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Área de Imagenología



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Noviembre 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 3 de 9

3. Algoritmo

Se debe colocar la fórmula matemática declarada para el indicador.

$$\frac{\text{Numero de placas de desecho}}{\text{Numero de placas utilizadas en el mes}} \times 100 =$$


4. Resultados del algoritmo

Colocar el algoritmo con los resultados de los meses que se van a presentar

$$\frac{0 \text{ placa de desecho}}{500 \text{ placas utilizadas en noviembre 2020}} \times 100 = 0.0\%$$

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

Esquematización de los resultados del algoritmo.

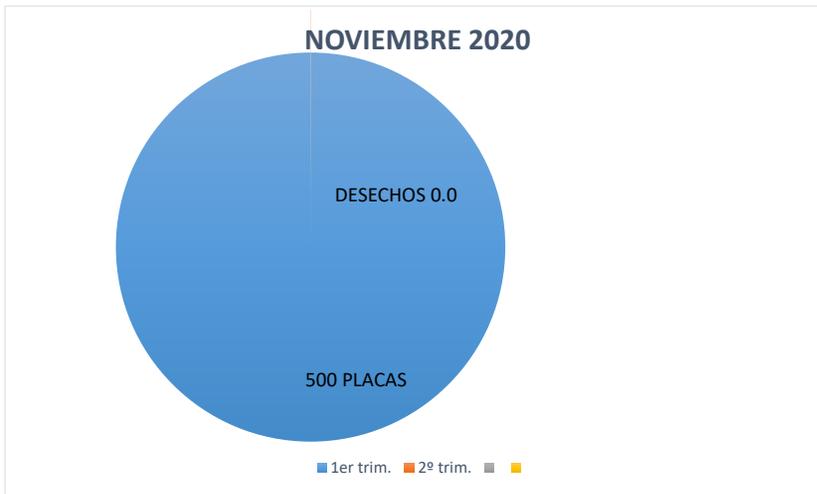



Elaboró	Validó
Alondra Lazcano Tellez Tecnica Radióloga	Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Area de Imagenología
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Noviembre 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 4 de 9

6. Representación gráfica comparativa

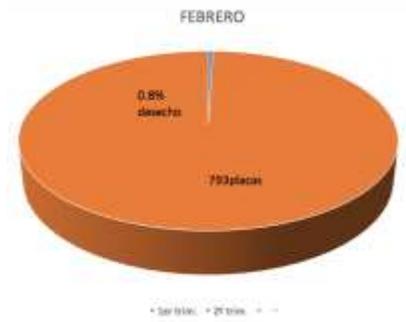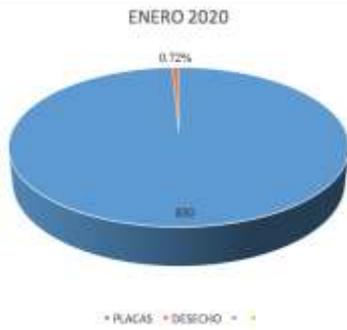

Elaboró

Alondra Lazcano Tellez
Técnica Radióloga

Validó

Aldo Isaac Vázquez Godínez
Jefe del Área de Imagenología



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:
Imagenología

Vigente a partir de:
Noviembre 2020
Versión: 3.0


Clave: CEMA-RG-CA-II-13

Página 5 de 9

MARZO, 2020




ABRIL

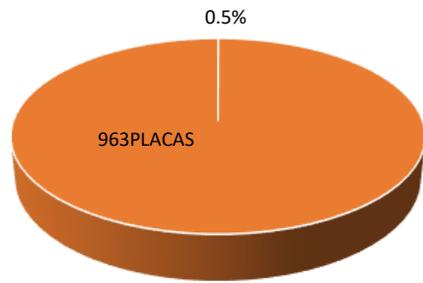

MAYO



JUNIO

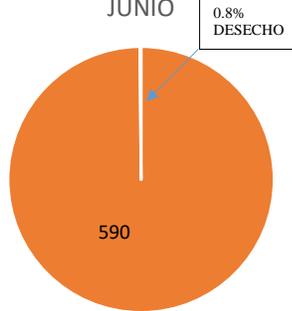

Elaboró

Alondra Lazcano Tellez
Técnica Radióloga

Validó

Aldo Isaac Vázquez Godínez
Jefe del Área de Imagenología



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



INFORME DE INDICADOR



Departamento / Área:
Imagenología

Vigente a partir de:
Noviembre 2020

Clave: CEMA-RG-CA-II-13

Versión: 3.0

Página 6 de 9

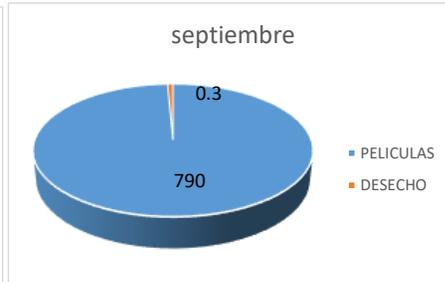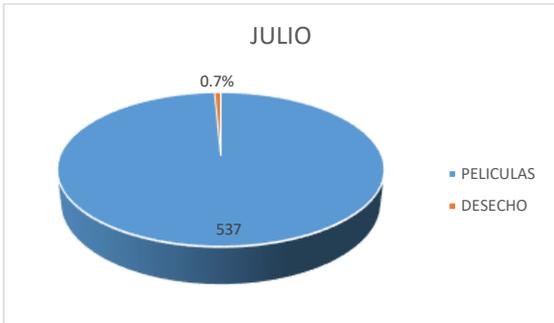

Elaboró

Alondra Lazcano Tellez
Técnica Radióloga

Validó

Aldo Isaac Vázquez Godínez
Jefe del Área de Imagenología

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Noviembre 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 7 de 9



Elaboró	Validó
Alondra Lazcano Tellez Técnica Radióloga	Aldo Isaac Vázquez Godínez Jefe del Area de Imagenología
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Noviembre 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 8 de 9

7. Conclusiones

1.- El área de Imagenología no presenta desecho de película radiográfica durante el mes de octubre cumpliendo así con el objetivo de este indicador.

Elaboró

Alondra Lazcano Tellez
Técnica Radióloga

Validó

Aldo Isaac Vázquez Godínez
Jefe del Área de Imagenología



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Imagenología	Vigente a partir de: Noviembre 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 9 de 9

Elaboró

Alondra Lazcano Tellez
Técnica Radióloga

Validó

Aldo Isaac Vázquez Godínez
Jefe del Área de Imagenología

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.